



INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, se reúne en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, sito en la casa de la calle Mcal. López y Cnel. Casal de esta ciudad, el COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, a los efectos de evaluar conforme a los criterios establecidos, la LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 36/2026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA GENERAL ELECTRIC, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID Nº 490.650. El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 7.021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y reglamentada por Decreto Nº 2264/24. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según consta en la Resolución D. Nº 189/2026.-

ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA

- La Nota UNA/FCM/DAF/DAHC. Nº 366/2026 del Departamento de Administración del Hospital de Clínicas de fecha 18 de junio de 2026, por la cual la Encargada de Despacho del Departamento de Administración del Hospital de Clínicas solicita se inicie los trámites necesarios para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA GENERAL ELECTRIC, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS, con el Visto Bueno del Director General Asistencial del Hospital de Clínicas. -
- La Resolución D. Nº 1129/2026, por la cual se aprueba la Convocatoria y el Pliego de Bases y Condiciones para la LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 36/2026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA GENERAL ELECTRIC, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID Nº 490.650.-
- El Dictamen DCP Nº 50/2026, del Departamento de Contrataciones Públicas, por la cual valida la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.-
- El Decreto Nº 2.264/24 que reglamenta la Ley Nº 7.021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".-
- El Acta de Apertura de Ofertas de fecha 21 de julio de 2026.-
- La Nota UNA/FCM/DAF/DCP. Nº 982/2026, recibida el 21 de julio a las 12:14hs., por la cual el Departamento de Contrataciones Públicas remite documentaciones, para la evaluación del proceso.-
- El Dictamen Nº 83/2.026 de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas.-
- El Memorándum UNA/DGA/DEM Nº 104/2026, recibido en fecha 29 de julio de 2026, por el cual el Jefe del Departamento de Electromedicina del Hospital de Clínicas, remite la Evaluación Técnica.-

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Ofertas, observándose la recepción de 1 (Una) oferta: **MARE PARAGUAY S.A.** -

Referencias:

- Método de Evaluación:** Basado únicamente en precio.-
- Sistema de Adjudicación:** Total.-
- No se realizó corrección aritmética de la oferta.-**
- Se adjunta Resolución D. Nº 189/2.026, por la cual se actualiza la conformación del Comité de Evaluación de Contrataciones Públicas.-

Observación:

Se hace mención que se procedió al Acto de Apertura de sobres en la primera convocatoria con 1 (Un) oferente, considerando la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo obedeciendo al uso permanente e intensivo de los equipos, conforme expresa Encargada de Despacho del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Médicas en La Nota UNA/FCM/DAF/DAHC. Nº 425/2026.-

SEGUNDO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal sustancial**, llevado a cabo por el Comité el cual concluye que:

Documentos Sustanciales – Personas Jurídicas	MARE PARAGUAY S.A.
Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP. <i>En caso de presentar la Garantía de Mantenimiento de Oferta en formato de Declaración Jurada con Certificación Notarial</i>	Cumple



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

de Firma, tal Declaración Jurada u otros documentos cuyas firmas sean certificadas por escribanos públicos, deben llevar insertos una constancia notarial en la que se individualice el número de Hoja Notarial de Certificación de Firmas que lo acompaña, para su validez.	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	Cumple
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	Cumple

A continuación, se expone el Dictamen N° 83/2026, que hace referencia al análisis jurídico de la documentación legal presentada por el oferente:

Dictamen N° 83/2.026.-

AL : Sres. Comité de Evaluación de Ofertas
FCM/UNA

DEL : Abog. Juan Carlos Barreiro Perrotta, Asesor Jurídico
Decanato – Unidad Operativa de Contrataciones – FCM/UNA

REF. Dictamen Legal sobre LMCN N° 36/2026 “Mantenimiento Preventivo, Correctivo para Máquinas de Anestesia General Electric, Pertenecientes al Hospital de Clínicas”. ID N° 490.650. –

FECHA : Asunción, 27 de julio de 2026. –

Oferentes

1. Mare Paraguay S.A. –

Conclusión:

Realizado el análisis exclusivamente jurídico de la documentación legal que se acompaña a la oferta presentada, en el marco de este llamado por Licitación de Menor Cuantía Nacional y aplicando estrictamente los criterios de evaluación previstos en los Arts. 34 y 37 de la Ley N° 7021/2022, y 79 del Decreto Reglamentario N° 2264/2024, se recomienda al Comité de Evaluación considerar válidamente la oferta presentada. –

Se hace mención que la oferente presenta constancia del Perfil del Proveedor, cuyos datos fueron verificados a través del Sistema, de conformidad a lo preceptuado en las disposiciones contenidas en la Resolución DNCP N° 2939/2024, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento del Registro de Proveedores del Estado, del Registro de Compradores Públicos y otros Registros que deben obrar en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. –

Es mi dictamen. –

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS

27 JUL 2026

M.E. N° 436

FOLIATURA: 11-48

RECIBIDO POR:

OBS: La recepción de este documento no implica la validez del mismo

Juan Carlos Barreiro Perrotta
Abogado
Mat. C.S.J. N° 8955

Pic. Lizania Cardozo
Miembro del Comité
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
F.C.M. U.N.A.



Criterio del Comité:

Con base en lo dictaminado y verificada la oferta presentada por la empresa: **MARE PARAGUAY S.A.**, se concluye que las ofertas cumplen con la documentación formal de carácter sustancial requerida en el Pliego de Bases y Condiciones por lo que seguirá siendo evaluada en los siguientes puntos del presente informe.-

Observación: Para los oferentes que presentaron junto con su Oferta la "Constancia del Perfil del Proveedor", que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente PBC, conforme indica la Resolución DNCP N° 2939/2024, se detalla a continuación los datos obrantes en la misma:

Empresa Oferente	RUC	Número de Constancia	Correo Electrónico según Constancia
MARE PARAGUAY S.A.	80097071-3	1887968	Arturo.acevedo@themaregroup.com

TERCERO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal no sustancial**, llevado a cabo por el Comité en cual concluye que:

DESCRIPCION	MARE PARAGUAY S.A.
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	Cumple
Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)	Cumple
Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar – Sección Formularios	Cumple
Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	Cumple
Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)	Cumple
Capacidad Financiera Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: 1. Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL: Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2023, 2024, 2025) a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2023, 2024, 2025). b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2023, 2024, 2025). c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los 3 últimos años (2023, 2024, 2025), no deberá ser negativo. 2. Para contribuyentes IRPC/IRE SIMPLE: Deberá cumplir el siguiente parámetro. Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2023, 2024, 2025. 3. Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP, Deberá cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2023, 2024, 2025. 4. Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Deberá cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2023, 2024, 2025.	Cumple
Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.	Cumple
b. Balance General y Estado de Resultados de los años 2023, 2024, 2025 para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL.	Cumple
c. Formulario N° 501 años 2023, 2024, 2025, para los contribuyentes IRE/IRE SIMPLE.	No Aplica
d. Formulario N° 515 años 2023, 2024, 2025 para los contribuyentes del IRP-RSP.-	No Aplica
e. Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General de los años 2023, 2024, 2025.	No Aplica
Experiencia Requerida * Demostrar la experiencia en mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos Biomédicos con facturaciones de venta, y/o recepciones finales, por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 3 años (2023, 2024, 2025). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año. *La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.	Cumple
Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia	
1. Copia de facturaciones, y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple
Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente municipal, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial.	Cumple
Capacidad Técnica El oferente deberá demostrar evidencia documentada que demuestre que cumple con los requisitos de capacidad técnica.	Cumple
El oferente deberá presentar los documentos detallado en el siguientes punto.	
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica	
a) Currículo del personal técnico encargado. Copias de los certificados de cursos de capacitación en mantenimiento y reparación de equipos biomédicos similares a ser mantenidos y/o reparados.	Cumple
b) Copia del registro profesional de al menos un (1) profesional biomédico o en electrónica médica, expedido por el MSP y BS.	Cumple
c) Habilitación del Servicio Técnico de Equipos Médicos, habilitado por la DINAVISA	Cumple
Autorización del Fabricante	
Si , presentar Autorización del Fabricante conforme al formulario de la Sección Formularios OBS: Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios. La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.	Cumple
Periodo de validez de la Garantía de los bienes El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:	
La garantía de los servicios será de 30 días corridos posterior al servicio. Presentar Declaración Jurada que garantice los servicios prestados	Cumple

Durante la evaluación se requirió formalmente mediante nota del Comité de Evaluación de Contrataciones lo detallado a continuación:

La solicitud se realizó el 27/07/2026: La documentación requerida debía ser entregada hasta las 8:00hs del día miércoles, 29 de julio de 2026.
*** Obs.:** Toda documentación y/o aclaración remitida fuera del plazo establecido se tendrá por no presentada. –

A MARE PARAGUAY S.A. según nota UNA_FCM_CCEP N° 456/2026:

1. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar – Sección Formularios

Página 4 de 19



2. **Periodo de validez de la Garantía de los bienes**
El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

La garantía de los servicios será de 30 días corridos posterior al servicio. **Presentar Declaración Jurada que garantice los servicios prestados**

La firma individualizada respondió en tiempo y forma lo requerido, según consta en el reporte del e-mail recibido a las 10:26 hs del 28 de julio de 2026, con Mesa de Entrada del Comité N° 438.-

CUARTO: En consideración a lo establecido en el Art. 19 del Decreto N° 2264/24 y el Pliego de Bases y Condiciones, que reglamenta el análisis de las prohibiciones establecidas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se realiza la verificación a través de la página del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (www.paraguay.gov.py) y del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) (www.contrataciones.gov.py). De lo que resulta lo siguiente:

EMPRESA: MARE PARAGUAY S.A.													
Nro.	C.I. N°	Nombre y Apellido	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	Constancia Nro.	Código de Verificación Nro.	
1	1.291.178	Juan Pedro Raggio Garcia	Actualmente, no se encontraron Registros para la C.I.								9.751.654	9078a07e	
2	8.653.471	Ricardo Hugo Morel Frigerio	Actualmente, no se encontraron Registros para la C.I.								9.751.632	94966fb5	
3	2.213.703	Ubaldo Evaristo Estigarribia Silvero	Actualmente, no se encontraron Registros para la C.I.								9.751.663	a87dd1f5	

- **Observación:** las Constancias podrán ser validadas en línea a través del portal oficial del MITIC (www.paraguay.gov.py)

Referencia de las verificaciones realizadas (Calificación Legal – PBC)

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6° El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

➤ Con base en la documentación referida, se concluye que los oferentes mencionados, actualmente, cumplen con la Capacidad Legal ya que no se encontraron datos que le fueran atribuibles para la descalificación.-

QUINTO: se procede a evaluar la capacidad financiera de la siguiente empresa: **MARE PARAGUAY S.A.**, de lo que resulta lo siguiente:

EMPRESA: MARE PARAGUAY S.A.									
Tipo de Contribuyente	Índices Financieros	Datos Analizados	Valores Analizados por Año			Ratios por Año			Promedio
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	
IRACIS	Liquidez	ACTIVO CORRIENTE	40.070.350.460	47.900.255.956	37.747.507.926	2,0	1,9	3,2	2,38
		PASIVO CORRIENTE	20.364.188.573	24.687.566.041	11.685.858.319				
	Endeudamiento	ACTIVO TOTAL	43.206.530.100	50.620.508.611	40.433.724.099	0,6	0,5	0,3	0,44
		PASIVO TOTAL	23.970.810.166	24.746.391.616	11.685.858.319				
	Rentabilidad	CAPITAL	6.540.682.068	6.540.682.068	6.540.682.068	58,7	70,5	60,6	63,28
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.840.311.203	4.611.460.893	3.966.029.883				

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

1. Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL: Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2023, 2024 y 2025).

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 años (2023, 2024, 2025).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 años (2023, 2024, 2025).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 años (2023, 2024, 2025), no deberá ser negativo.

2. Para contribuyentes IRPC/IRE SIMPLE: Deberá cumplir el siguiente parámetro.

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2023, 2024 y 2025.

3. Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP, Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2023, 2024 y 2025.

4. Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los últimos (6) seis meses.

Por tanto, la empresa: **MARE PARAGUAY S.A.**, de lo que resulta lo siguiente: **Cumple con la Capacidad Financiera** exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas.

SEXTO: se procede a evaluar experiencia de la empresa: **MARE PARAGUAY S.A.**, de lo que resulta lo siguiente:

1. *Demostrar la experiencia en mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos Biomédicos, con facturaciones de venta, contrato y/o recepciones finales, por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2023, 2024, 2025). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.*

EMPRESA OFERENTE: MARE PARAGUAY S.A.	
Monto Total Ofertado	144.942.000
Porcentaje Mínimo de Facturación Requerido (30% como mínimo del monto total ofertado)	43.482.600



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@cmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

Documentos Presentados	Año 2.023	Año 2.024	Año 2.025	Sumatoria Total	Observaciones
Acta N° 85/2025 - 12/03/2025	-	-	12.949.000	12.949.000	Corresponde al objeto del llamado.
Acta N° 391/2024 - 10/12/2024	-	890.169.500	-	890.169.500	Corresponde al objeto del llamado.
TOTAL				903.118.500	CUMPLE CON EL PORCENTAJE REQUERIDO EN EL PBC

2. La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

MARE PARAGUAY S.A.	
Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado	Cumple

Por tanto, la empresa oferente: **MARE PARAGUAY S.A., Cumple con la Experiencia** exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas.

SÉPTIMO: se procede a realizar el análisis de carácter técnico, conforme a los criterios establecidos en la Convocatoria y de conformidad a lo dispuesto en los artículos N° 52 y 53 de la Ley 7.021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y el Decreto N° 2.264 Reglamentario de la Ley, consecuentemente, se procedió a clasificar las ofertas según el monto de menor a mayor de lo que resulta lo siguiente:

Sistema de Adjudicación: Total

EMPRESA OFERENTE: MARE PARAGUAY S.A.								
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Precio unitario (Referencial)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	73171602-001	Mantenimiento preventivo general para ocho (8) máquina de anestesia marca GE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	17.800.000	1	17.600.000	17.600.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
2	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.555.000	1	1.560.000	1.560.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
3	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provision de Interfase de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.407.000	1	1.404.000	1.404.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
4	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Sensor de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.871.000	1	1.872.000	1.872.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
5	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Interfase de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.185.000	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
6	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN:	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	459.000	1	468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

		SGV22398012HA consistente en provisión de Brazal de PANI						
7	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Interfase de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.619.000	1	1.638.000	1.638.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
8	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.086.000	1	1.092.000	1.092.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
9	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.708.000	1	1.716.000	1.716.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
10	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	750.000	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
11	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.555.000	1	1.560.000	1.560.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
12	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provision de Interfase de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.407.000	1	1.404.000	1.404.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
13	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Sensor de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.872.000	1	1.872.000	1.872.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
14	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Interfase de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.170.000	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
15	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Brazal de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	468.000	1	468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
16	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN:	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	858.000	1	858.000	858.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

		SR821240013WA consistente en provisión de Batería Interna						
17	80111613- 9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	750.000	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
18	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256 consistente en provisión de Kit de dos sensores de flujo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.580.000	1	8.580.000	8.580.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
19	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256 consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	858.000	1	858.000	858.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
20	80111613- 9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	750.000	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
21	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Válvula APL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.730.000	1	2.730.000	2.730.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
22	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Kit anual de módulo de gases	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.555.000	1	1.560.000	1.560.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
23	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Interfase de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.170.000	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
24	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Brazal de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	468.000	1	468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
25	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Interfase de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.638.000	1	1.638.000	1.638.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
26	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Latigüillos de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.092.000	1	1.092.000	1.092.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
27	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN:	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	858.000	1	858.000	858.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

		SR821540014WA consistente en provisión de Batería Interna						
28	80111613- 9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	750.000	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
29	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provisión de bomba para modulo de Gases N-CAIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.600.000	1	3.600.000	3.600.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
30	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provision de Interfase de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.407.000	1	1.404.000	1.404.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
31	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provisión de Sensor de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.872.000	1	1.872.000	1.872.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
32	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	858.000	1	858.000	858.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
33	80111613- 9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	750.000	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
34	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de sensor de flujo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.145.000	1	4.290.000	4.290.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
35	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de Interfase de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.407.000	1	1.404.000	1.404.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
36	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Sensor de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.872.000	1	1.872.000	1.872.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
37	73171602- 001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN:	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.170.000	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

		SQF20430020WA consistente en provisión de Interfase de PANI						
38	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Brazal de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	468.000	1	468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
39	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Interfase de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.638.000	1	1.638.000	1.638.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
40	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.092.000	1	1.092.000	1.092.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
41	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Tubuladura de Bolsa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.950.000	1	1.950.000	1.950.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
42	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	858.000	1	858.000	858.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
43	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	750.000	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
44	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.555.000	1	1.560.000	1.560.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
45	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provision de Brazo de bolsa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.900.000	1	1.900.000	1.900.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
46	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Interfase de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.170.000	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:
47	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN:	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	468.000		468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacio nal:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

		SS61941031HA consistente en provisión de Brazal de PANI						
48	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Interfase de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.638.000	1	1.638.000	1.638.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
49	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.092.000	1	1.092.000	1.092.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
50	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.708.000	1	1.716.000	1.716.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
51	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Modulo de Gases	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	38.950.000	1	39.900.000	39.900.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
52	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	750.000	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
53	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.555.000	1	1.560.000	1.560.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
54	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de bomba para modulo de Gases N-CAIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.661.000	1	3.822.000	3.822.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
55	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Interfase de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.170.000	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
56	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Brazal de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	468.000	1	468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
57	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.638.000	1	1.638.000	1.638.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

		B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Interfase de ECG						
58	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.092.000	1	1.092.000	1.092.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
59	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Kit Encoder para máquina de anestesia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.950.000	1	1.950.000	1.950.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
60	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.708.000	1	1.716.000	1.716.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
61	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	750.000	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado _origen_nacional:
Total por Grupo:							144.942.000	
Total General Calculado:							144.942.000	

- El análisis de los Requisitos Técnicos de las ofertas para el presente ítem consta individualmente en el Informe Técnico adjunto. –

Se selecciona provisoriamente la **única oferta**, presentada por la empresa **MARE PARAGUAY S.A.**, a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por **MARE PARAGUAY S.A.**, **Cumple** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto. –

Analizado el precio ofertado por **MARE PARAGUAY S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el **Análisis de precios ofertados**, correspondiente a la SECCIÓN de

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación. –

Observación: * Considerando que no se ha cotizado servicio de Origen Nacional, no se ha otorgado el beneficio del Margen de Preferencia.

OCTAVO: Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, que incluyen los aspectos legales, técnicos y económicos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 31 del Decreto Reglamentario N° 2264/24, concordante con los Art. 54 y 55, de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 36/2026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA GENERAL ELECTRIC, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID N° 490.650**, a la empresa:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

MARE PARAGUAY S.A.							
Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA GENERAL ELECTRIC, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	73171602-001	Mantenimiento preventivo general para ocho (8) máquina de anestesia marca GE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.600.000	17.600.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
2	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.560.000	1.560.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
3	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provision de Interfase de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.404.000	1.404.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
4	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Sensor de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.872.000	1.872.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
5	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Interfase de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
6	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Brazal de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
7	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Interfase de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.638.000	1.638.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
8	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.092.000	1.092.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
9	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.716.000	1.716.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
10	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
11	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.560.000	1.560.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
12	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provision de Interfase de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.404.000	1.404.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

13	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Sensor de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.872.000	1.872.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
14	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Interfase de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
15	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Brazal de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
16	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	858.000	858.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
17	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
18	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256 consistente en provisión de Kit de dos sensores de flujo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.580.000	8.580.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
19	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256 consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	858.000	858.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
20	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
21	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Válvula APL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.730.000	2.730.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
22	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Kit anual de módulo de gases	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.560.000	1.560.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
23	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Interfase de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
24	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Brazal de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
25	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Interfase de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.638.000	1.638.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
26	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN:	unidad de medida: Unidad	1	1.092.000	1.092.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

		SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	presentación: EVENTO				
27	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	858.000	858.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
28	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
29	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provisión de bomba para modulo de Gases N-CAIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.600.000	3.600.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
30	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provision de Interfase de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.404.000	1.404.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
31	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provisión de Sensor de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.872.000	1.872.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
32	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	858.000	858.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
33	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
34	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de sensor de flujo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.290.000	4.290.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
35	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de Interfase de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.404.000	1.404.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
36	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Sensor de SpO2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.872.000	1.872.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
37	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Interfase de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
38	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Brazal de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

39	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Interfase de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.638.000	1.638.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
40	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.092.000	1.092.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
41	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Tubuladura de Bolsa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.950.000	1.950.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
42	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	858.000	858.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
43	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
44	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.560.000	1.560.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
45	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provision de Brazo de bolsa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.900.000	1.900.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
46	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Interfase de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
47	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Brazal de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
48	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Interfase de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.638.000	1.638.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
49	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.092.000	1.092.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
50	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Batería Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.716.000	1.716.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
51	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	39.900.000	39.900.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
E-mail: evaluacion_contrataciones@fcmuna.edu.py
San Lorenzo – Paraguay

		consistente en provisión de Modulo de Gases					
52	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
53	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.560.000	1.560.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
54	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de bomba para modulo de Gases N-CAIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.822.000	3.822.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
55	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Interfase de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.170.000	1.170.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
56	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Brazal de PANI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	468.000	468.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
57	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Interfase de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.638.000	1.638.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
58	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.092.000	1.092.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
59	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Kit Encoder para máquina de anestesia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.950.000	1.950.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
60	73171602-001	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Bateria Interna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.716.000	1.716.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
61	80111613-9999	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	600.000	600.000	procedencia: EEUU nro_certificado_origen_nacional:
Total por Grupo:						144.942.000	
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN						144.942.000	

Resumen de la Propuesta de Adjudicación		
Empresa	Monto Total de la Propuesta en Guaranies	Monto Total de la Propuesta en letras
MARE PARAGUAY S.A.	144.942.000	Guaranies: Ciento cuarenta y cuatro millones novecientos cuarenta y dos mil.-

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 09:00hs., a los 30 días del mes de julio del dos mil veintiséis. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.




Se adjunta:

1. El Dictamen N° 83/2.026 de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas.
2. El Memorándum UNA/DGA/DEM N° 104/2026, recibido en fecha 29 de julio de 2026, por el cual el Jefe del Departamento de Electromedicina del Hospital de Clínicas, remite la Evaluación Técnica.
3. Resolución D. N° 189/2.026, por la cual se actualiza la conformación del Comité de Evaluación de Contrataciones Públicas.–

Observación:

El Informe de Evaluación, el Cuadro Comparativo de Ofertas y el Cuadro Propuesto de Adjudicación, cuentan con las firmas de los miembros.–


Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.–

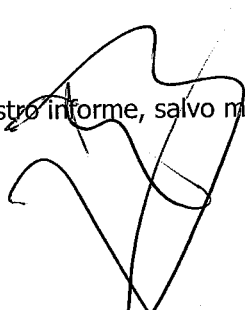
PROF. DR. JORGE GIUBI BOBEDA
MIEMBRO DEL COMITÉ


ARQ. CRISTINA ORUÉ
MIEMBRO DEL COMITÉ


LIC. VÍCTOR VILLALBA
MIEMBRO DEL COMITÉ


UNIV. ANDREA BRIZUELA
MIEMBRO DEL COMITÉ


PROF. DR. NELSON MARTINEZ VILLALBA
MIEMBRO DEL COMITÉ


LIC. LIZANIA CARDOZO
MIEMBRO DEL COMITÉ


LIC. MARCELA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

Dictamen N° 83/2.026.-

AL : Sres. Comité de Evaluación de Ofertas
FCM/UNA

DEL : Abog. Juan Carlos Barreiro Perrotta, Asesor Jurídico
Decanato – Unidad Operativa de Contrataciones – FCM/UNA

REF. Dictamen Legal sobre LMCN N° 36/2026 “Mantenimiento Preventivo, Correctivo para Máquinas de Anestesia General Electric, Pertenecientes al Hospital de Clínicas”. ID N° 490.650. –

FECHA : Asunción, 27 de julio de 2026. –

Oferentes

1. Mare Paraguay S.A. –

Conclusión:

Realizado el análisis exclusivamente jurídico de la documentación legal que se acompaña a la oferta presentada, en el marco de este llamado por Licitación de Menor Cuantía Nacional y aplicando estrictamente los criterios de evaluación previstos en los Arts. 34 y 37 de la Ley N° 7021/2022, y 79 del Decreto Reglamentario N° 2264/2024, se recomienda al Comité de Evaluación considerar válidamente la oferta presentada. –

Se hace mención que la oferente presenta constancia del Perfil del Proveedor, cuyos datos fueron verificados a través del Sistema, de conformidad a lo preceptuado en las disposiciones contenidas en la Resolución DNCP N° 2939/2024, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento del Registro de Proveedores del Estado, del Registro de Compradores Públicos y otros Registros que deben obrar en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. –

Es mi dictamen.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	
27 JUL 2026	
M.E. N° 436	num. 11-49
FOLIATURA: —	RECIBIDO POR: —
OBS: La recepción de este documento no implica la validez del mismo	

Juan Carlos Barreiro Perrotta
Abogado
Mat. C.S.J. N° 8955

Lic. Lizania Cardozo
Miembro del Comité
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
F.C.M. U.N.A.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Dirección General Asistencial - Hospital de Clínicas
Departamento de Electromedicina
Avda. Mcal. López y Coronel Casal - Campus Universitario
E-mail: electromedicina@fcmuna.edu.py
San Lorenzo - Paraguay



UNA/DGA/DEM N° 104/2026

MEMORANDUM

A: Lic. Rocío Viscarra, Jefa - Departamento de Administración HC.
DE: Dr. César Yegros, Jefe - Dpto. de Electromedicina.
FECHA: 29/07/2026.
ASUNTO: Evaluación Técnica LMCN N° 36/2026


Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quienes corresponda, a fin de remitir la segunda evaluación técnica, del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA GENERAL ELECTRIC, PERTENECIENTES AL HOSPITALDE CLÍNICAS. En adjunto la evaluación mencionada.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.


A: Comité
Lic. Rocío Viscarra G.
Administradora
Hosp. de Clínicas
F.C.M. - U.N.A.

Dr. César Yegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
FCM - U.N.A.

Dr. César Yegros
Jefe del Dpto. de Electromedicina

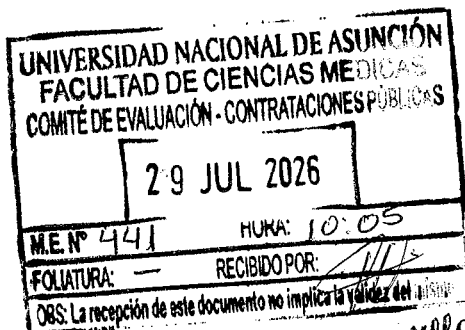

Lic. Víctor Villalba
Miembro del Comité
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
F.C.M. U.N.A.

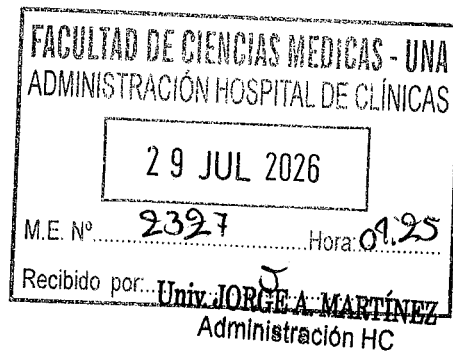

Fecha y Hora de Apertura de Ofertas: martes, 21 de julio de 2026 - 9:30hs	
Fecha de Inicio y Entrega de Evaluación: 23/07/2026 - 29/07/2026	
Empresa Oferente: MARE PARAGUAY S.A.	
Conclusión Técnica: Verificados los documentos presentados se concluye que cumple con los requisitos técnicos del Pliego de Bases y Condiciones	
Ítems Ofertados	Lote Total (Grupo 1)
Detalle del Producto Solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones:	Se acompaña EETT en la hoja siguiente.-
Procedencia:	EEUU
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica	
a) Currículo del personal técnico encargado. Copias de los certificados de cursos de capacitación en mantenimiento y reparación de equipos biomédicos similares a ser mantenidos y/o reparados.	CUMPLE
b) Copia del registro profesional de al menos un (1) profesional biomédico o en electrónica médica, expedido por el MSP y BS.	CUMPLE
c) Habilitación del Servicio Técnico de Equipos Médicos, habilitado por la DINAVISIA	CUMPLE
Autorización del Fabricante	
Si, presentar Autorización del Fabricante conforme al formulario de la Sección Formularios OBS: Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios. La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.	CUMPLE
Visita al sitio de ejecución del contrato	
Si, podrá reemplazar con Declaración Jurada.	CUMPLE
Periodo de validez de la Garantía de los bienes	
El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:	
La garantía de los servicios será de 30 días corridos posterior al servicio. Presentar Declaración Jurada que garantice los servicios prestados	CUMPLE

Dr. Cesar Moggi
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - U.N.A.

Nº. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
1	Mantenimiento preventivo general para ocho (8) máquina de anestesia marca GE	Mantenimiento preventivo general para ocho (8) máquina de anestesia marca GE
2	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases
3	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provision de Interfase de SpO2	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provision de Interfase de SpO2
4	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Sensor de SpO2	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Sensor de SpO2
5	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Interfase de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Interfase de PANI
6	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Brazal de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Brazal de PANI
7	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Interfase de ECG	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Interfase de ECG
8	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG
9	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Batería Interna	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA consistente en provisión de Batería Interna
10	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM722480032MA, Monitor B155 con SN: SGV22398012HA

Dr. Cesar
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - U.N.A

11	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Kit de módulo de gases
12	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provision de Interfase de SpO2	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provision de Interfase de SpO2
13	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Sensor de SpO2	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Sensor de SpO2
14	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Interfase de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Interfase de PANI
15	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Brazal de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Brazal de PANI
16	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Batería Interna	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA consistente en provisión de Batería Interna
17	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC21210638WA, Monitor B155 con SN: SR821240013WA
18	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256 consistente en provisión de Kit de dos sensores de flujo	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256 consistente en provisión de Kit de dos sensores de flujo
19	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256 consistente en provisión de Batería Interna	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256 consistente en provisión de Batería Interna
20	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Aespire con SN: AMXK00256

Dr. Cesar Velazquez
Jefe
Servicio de Electromedicina

21	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Válvula APL	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Válvula APL
22	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Kit anual de módulo de gases	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Kit anual de módulo de gases
23	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Interfase de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Interfase de PANI
24	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Brazal de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Brazal de PANI
25	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Interfase de ECG	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Interfase de ECG
26	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Latiguillos de ECG
27	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Batería Interna	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA consistente en provisión de Batería Interna
28	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC21210643WA, Monitor B155 con SN: SR821540014WA
29	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provisión de bomba para modulo de Gases N-CAIO	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provisión de bomba para modulo de Gases N-CAIO

Dr. César Yegros
Jefe
Unidad de Electromedicina

30	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provision de Interfase de SpO2	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provision de Interfase de SpO2
31	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provision de Sensor de SpO2	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provision de Sensor de SpO2
32	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provision de Bateria Interna	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA consistente en provision de Bateria Interna
33	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 CNxt con SN: SPC20451228WA, Monitor B125 con SN: SQF20430011SA
34	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de sensor de flujo	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de sensor de flujo
35	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de Interfase de SpO2	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de Interfase de SpO2
36	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de Sensor de SpO2	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de Sensor de SpO2
37	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de Interfase de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de Interfase de PANI
38	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de Brazal de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provision de Brazal de PANI

Dr. Cesar Yegros
Jefe
Info. de Electromedicina

39	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Interfase de ECG	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Interfase de ECG
40	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Latiguillos de ECG
41	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Tubuladura de Bolsa	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Tubuladura de Bolsa
42	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Batería Interna	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA consistente en provisión de Batería Interna
43	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia 9100 C Nxt con SN: SPC20451229WA, Monitor B125 con SN: SQF20430020WA
44	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases
45	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provision de Brazo de bolsa	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provision de Brazo de bolsa
46	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Interfase de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Interfase de PANI
47	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Brazal de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Brazal de PANI

Dr. César Yegros
 Jefe
 Auto. de Electromedicina

48	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Interfase de ECG	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Interfase de ECG
49	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG
50	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Batería Interna	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Batería Interna
51	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Modulo de Gases	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA consistente en provisión de Modulo de Gases
52	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160087MA, Monitor B650 con SN: SS61941031HA
53	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Kit de módulo de gases
54	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de bomba para modulo de Gases N-CAIO	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de bomba para modulo de Gases N-CAIO
55	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Interfase de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Interfase de PANI
56	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Brazal de PANI	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Brazal de PANI

Dr. César Vargas
Jefe
Dpto. de Electromedicina

57	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Interfase de ECG	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Interfase de ECG
58	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Latiguillos de ECG
59	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Kit Encoder para máquina de anestesia	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Kit Encoder para máquina de anestesia
60	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Batería Interna	Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA consistente en provisión de Batería Interna
61	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA	Mano de obra tecnica del Mantenimiento correctivo para maquina de anestesia marca GE Anestesia Carestation 650 con SN: SM720160078MA, Monitor B155 con SN: SGV21188029HA

OBSERVACIÓN:

• El tiempo de respuesta que el oferente debe cumplir será de como máximo 24 hs (hábiles) a partir de la solicitud realizada por el Departamento de Electromedicina del Hospital de Clínicas.

• Si se diera el caso en que el equipo quede inoperativo, posterior a la asistencia técnica; el prestador de servicio deberá informar al Departamento de Electromedicina del Hospital de Clínicas el tiempo de parada del Equipo, dentro de las 24 hs (hábiles).

• El oferente prestatario del servicio deberá presentarse tanto al inicio como al término de la asistencia, en el Departamento de Electromedicina.

Dr. César Yegros

Jefe

Dpto. de Electromedicina

F.C.M. - U.N.A.

-10-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Castel - Campus Universitario
Telef. 130 6817623931 ext. 179 - e-mail: fcm@med.una.py WEB: www.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Resolución D N° 189 /2026
10/02/2026

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN". -

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Resolución D. N° 2520/2025, "POR LA CUAL SE DESIGNA AL PROF. DR. NELSON HUGO MARTÍNEZ VILLALBA, COMO DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA, A PARTIR DE LA PROMULGACIÓN DE LA PRESENTE".

La nota con M.E. N° 823/2026, del Prof. Dr. Jorge Giubi Bobeda, Coordinador del Comité de Evaluación de Contrataciones Públicas de la FCM/UNA, por la cual solicita la inclusión del Prof. Dr. Nelson Martínez Villalba, en reemplazo del Prof. Dr. Reinaldo Javier Escobar Cantero, tomando en consideración la Resolución D. N° 2520/2025.

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,
En uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

Art. 1° ACTUALIZAR la conformación del Comité de Evaluación de Contrataciones Públicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, conforme al siguiente detalle:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FUNCIÓN
1	Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA	Coordinador del Comité
2	Prof. Dr. NELSON MARTINEZ VILLALBA	Sub Coordinador del Comité
3	Arq. CRISTINA ORUE	Jefa del Departamento Técnico y de Mantenimiento
4	Lic. LIZANIA CARDOZO	Miembro del Comité
5	Lic. VICTOR VILLALBA	Miembro del Comité
6	Lic. MARCELA AYALA	Miembro del Comité
7	Univ. ANDREA BRIZUELA	Representante Suplente del CD - Estudiante Estudiantil

Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ
Secretaría de la Facultad




Mg. Prof. Dr. OSMAR M. CUENCA TORRES
Decano

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Mantener en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente

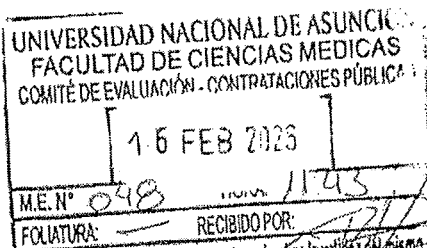

Nelson Villalba
Miembro del Comité
CONTRATACIONES PÚBLICAS
N.A.